


MAX-CORE* BIOPSIESYSTEM



AUTOMATISCHES EINMAL-BIOPSIESYSTEM



TRUGUIDE COAXIALNADEL FÜR MAX-CORE* BIOPSIESYSTEM

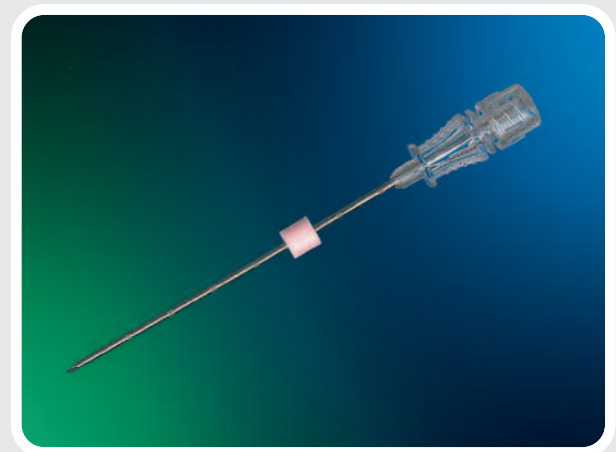

Typ

Max-Core* Einmalnadeln

Einschusstiefe: 22mm

Durchmesser [G]	[mm]	Länge [cm]	Farbcode	Bestell-Nr.
14	2,1	10	■	MC1410
14	2,1	16	■	MC1416
16	1,6	10	■	MC1610
16	1,6	16	■	MC1616
18	1,2	10	■	MC1810
18	1,2	16	■	MC1816
18	1,2	20	■	MC1820
18	1,2	25	■	MC1825
20	0,95	10	■	MC2010
20	0,95	16	■	MC2016
20	0,95	20	■	MC2020

Verpackungseinheit: 5 Stück

Typ

Truguide Coaxialnadeln

Durchmesser [G]	Länge [cm]	Farbcode	Bestell-Nr.
13	7,8	■	C1410A
13	13,8	■	C1416A
15	7,8	■	C1610A
15	13,8	■	C1616A
17	7,8	■	C1810A
17	13,8	■	C1816A
17	17,8	■	C1820A
19	7,8	■	C2010A
19	13,8	■	C2016A
19	17,8	■	C2020A

Verpackungseinheit: 5 Stück

MONOPTY* BIOPSIESYSTEM

MONOPTY*
AUTOMATISCHES EINMAL-BIOPSIESYSTEM




Typ
Monopty* Biopsiesystem

Durchmesser [G]	Farbcode	Länge [cm]	Bestell-Nr. 22mm ¹⁾	Länge [cm]	Bestell-Nr. 11mm ¹⁾
14	2,1	10	121410	9	211410
14	2,1	16	121416	15	211416
16	1,6	10	121610	9	211610
16	1,6	16	121616	15	211616
16	1,6	20	121620	19	211620
18	1,2	10	121810	9	211810
18	1,2	16	121816	15	211816
18	1,2	20	121820	19	211820
20	0,95	10	122010	9	212010
20	0,95	16	122016	15	212016
20	0,95	20	122020	19	212020

¹⁾ Einschusstiefe Verpackungseinheit: 10 Stück

TRUGUIDE COAXIALNADEL
FÜR MONOPTY* BIOPSIESYSTEM

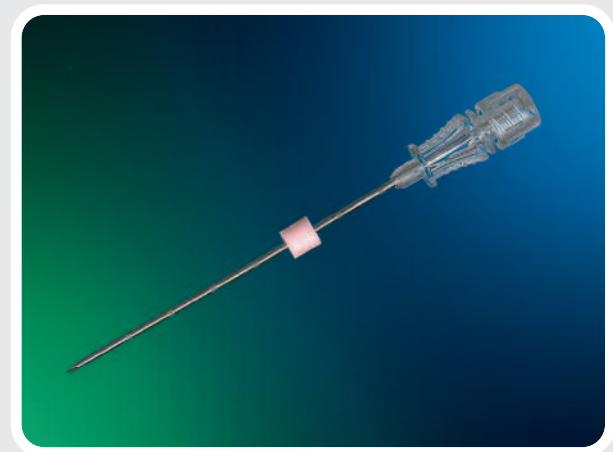

Typ
Truguide Coaxialnadel

Durchmesser [G]	Länge [cm]	Farbcode	Bestell-Nr.
13	7,8	■	C1410A
13	13,8	■	C1416A
15	7,8	■	C1610A
15	13,8	■	C1616A
15	17,8	■	C1620A
17	7,8	■	C1810A
17	13,8	■	C1816A
17	17,8	■	C1820A
19	7,8	■	C2010A
19	13,8	■	C2016A
19	17,8	■	C2020A

Verpackungseinheit: 5 Stück

www.bard.de

C. R. BARD GmbH

Wachhausstraße 6 • D-76227 Karlsruhe
TEL: +49 721 9445-124 • FAX: +49 721 9445-100

BARD MEDICA S.A.

Seestraße 64 • CH-8942 Oberrieden/Zürich
TEL: +41 44 722 53 60 • FAX: +41 44 722 53 70

BARD MEDICA S.A.

Thaliastraße 125a/1/5 • A-1160 Wien
TEL: +43 1 49 49 130 • FAX: +43 1 49 49 130-30